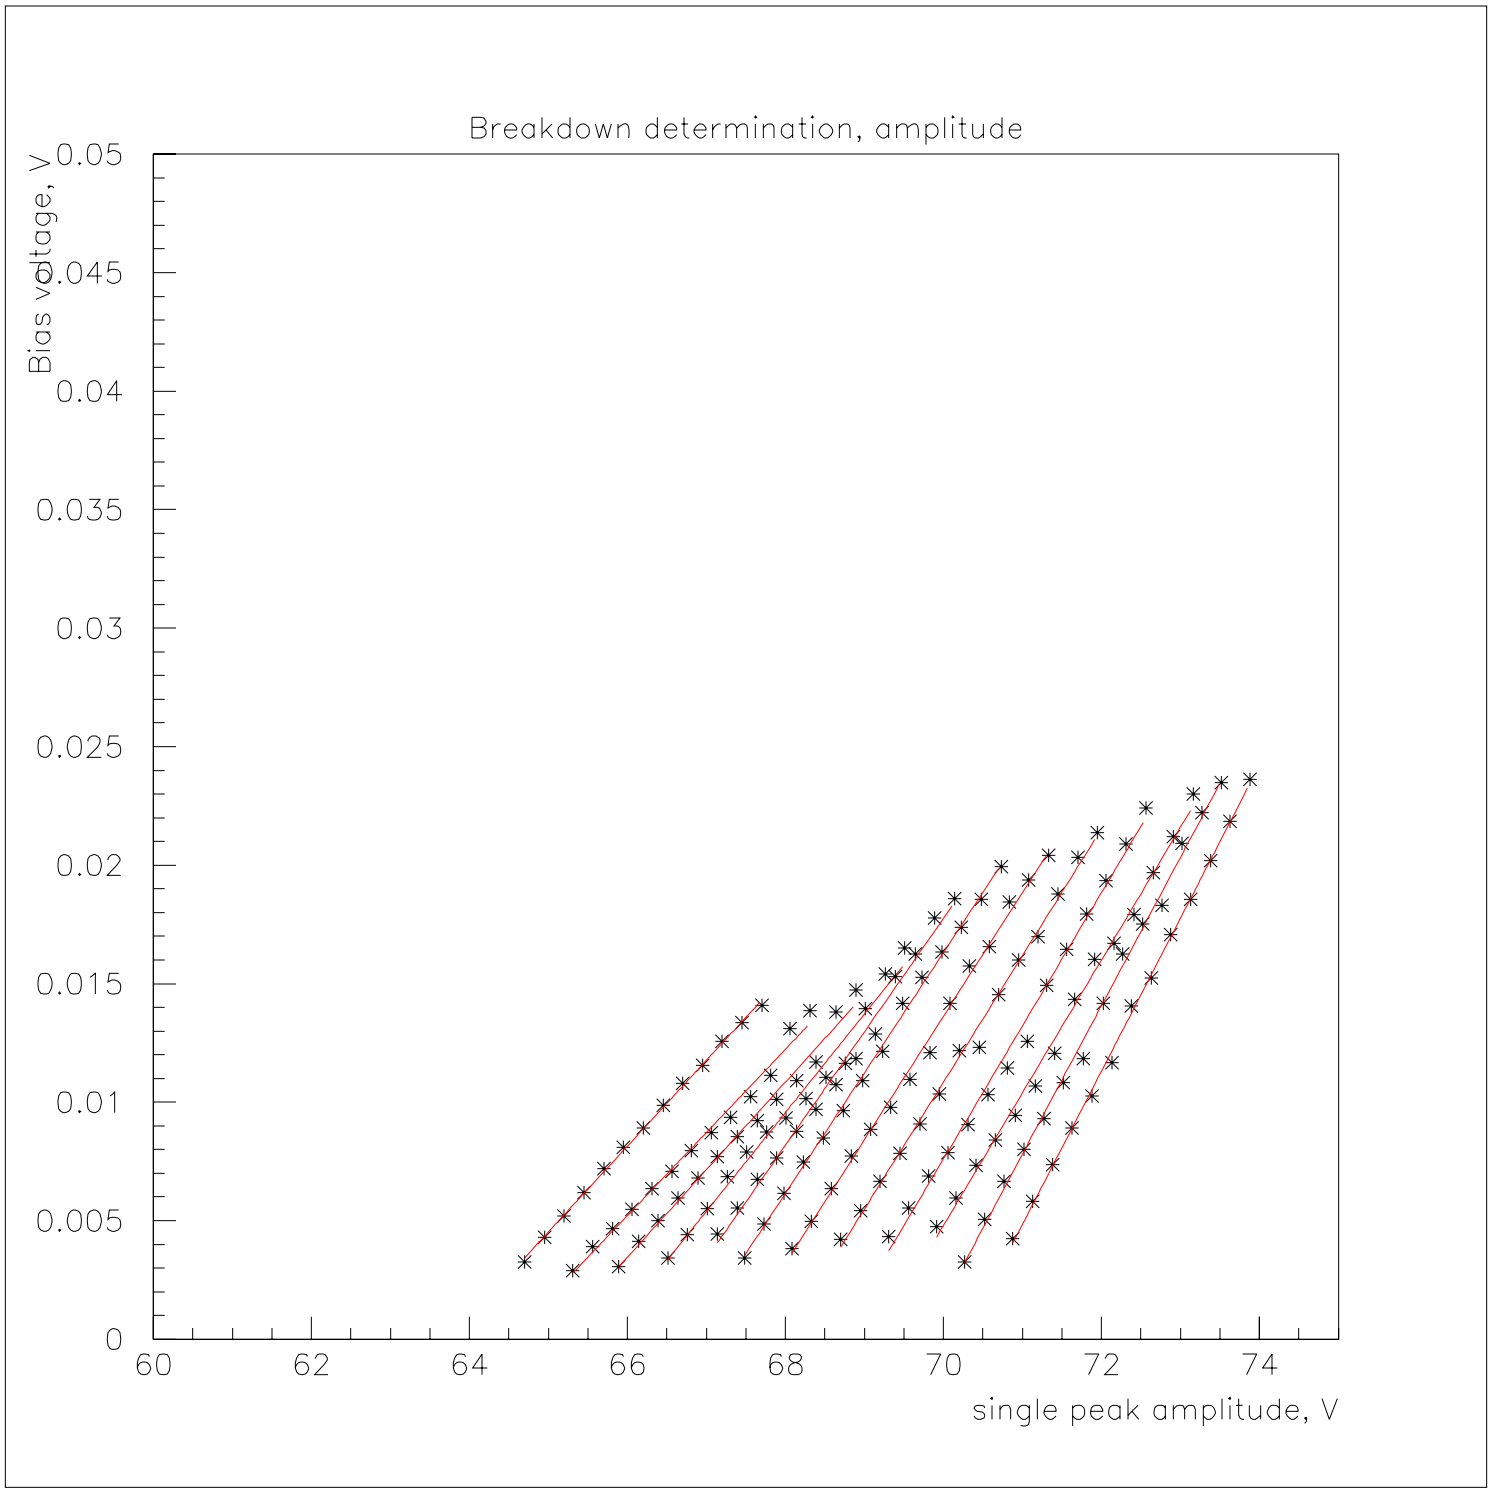
Breakdown determination, amplitude
Bias voltage, V
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
60
62
64
66
68
70
72
74
single peak amplitude, V

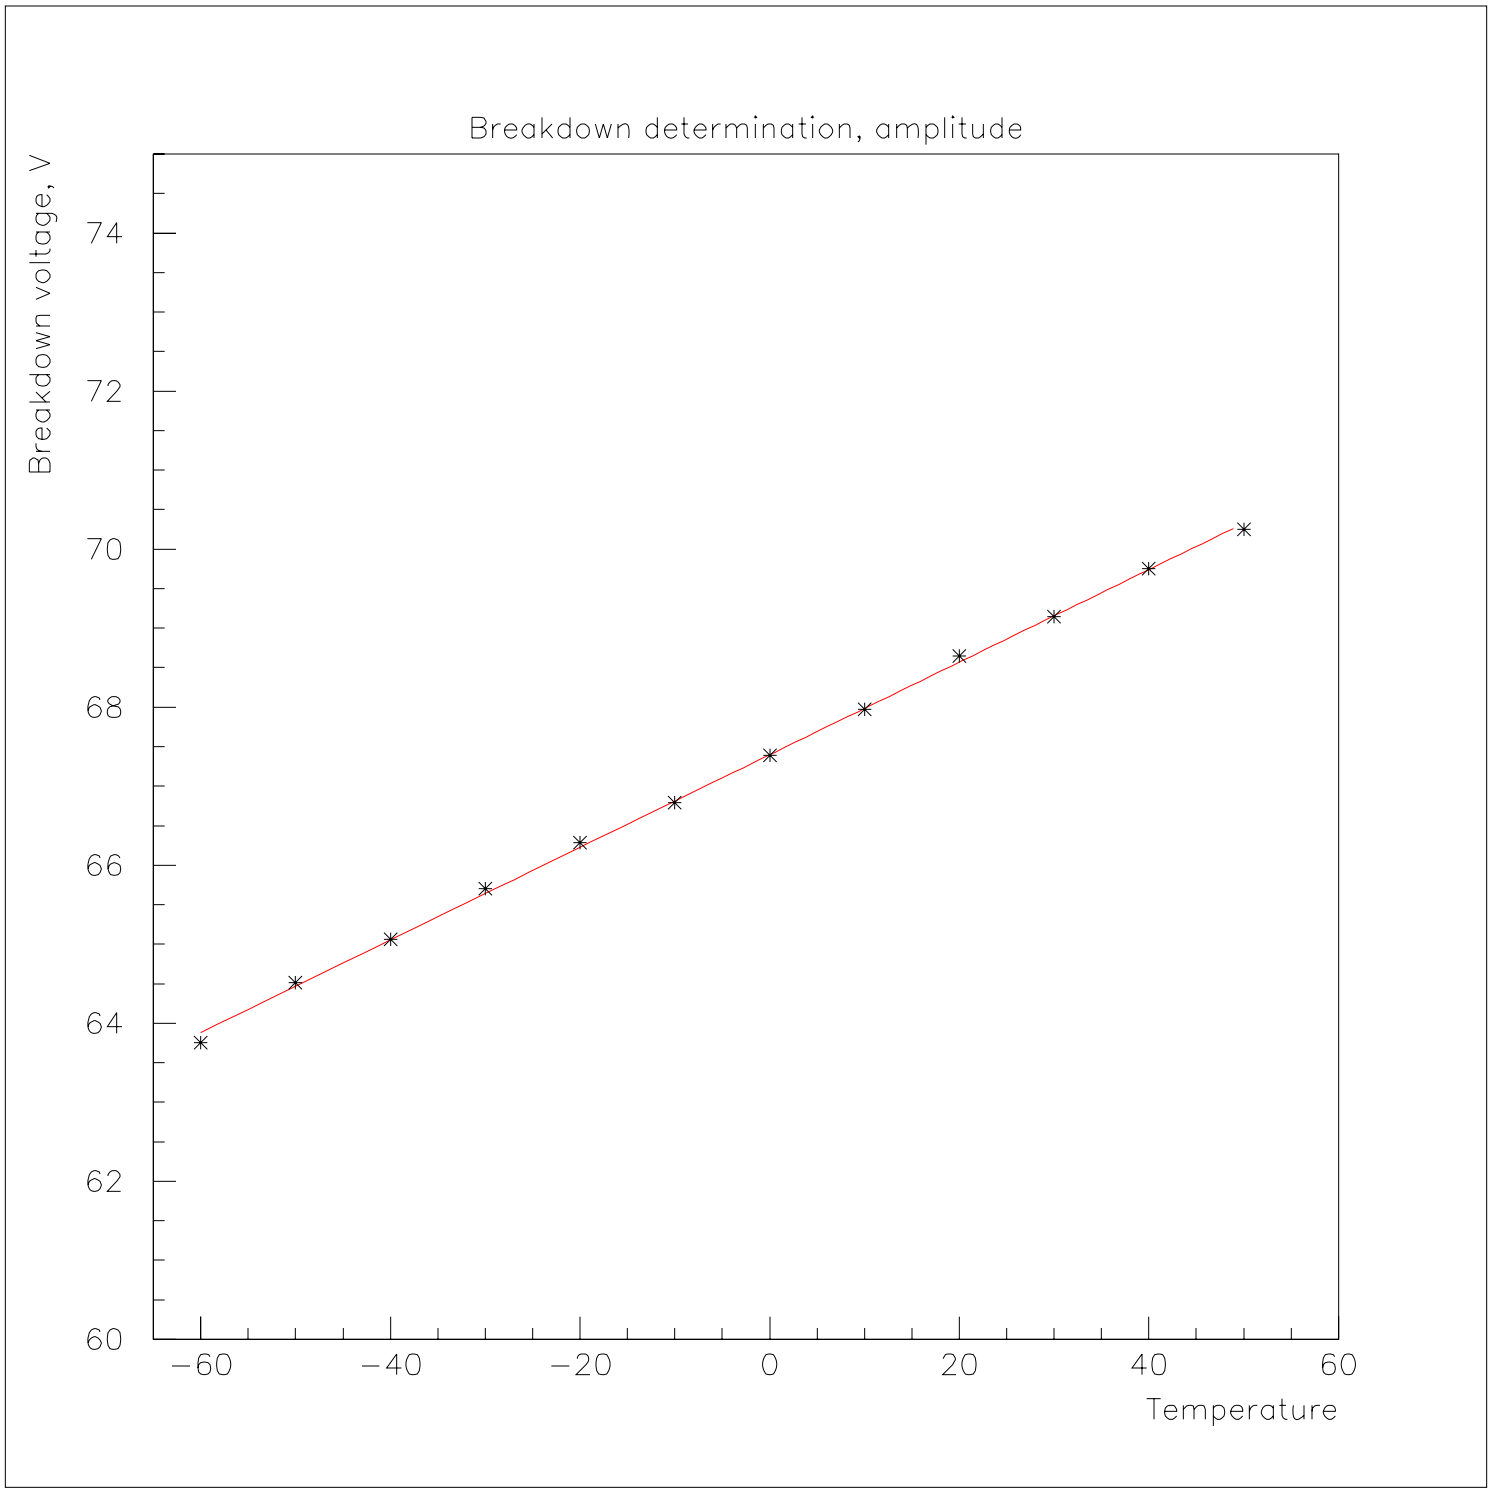
Breakdown determination, amplitude
Breakdown voltage, V
74
72
70
68
66
64
62
60
−60
−40
−20
0
20
40
60
Temperature

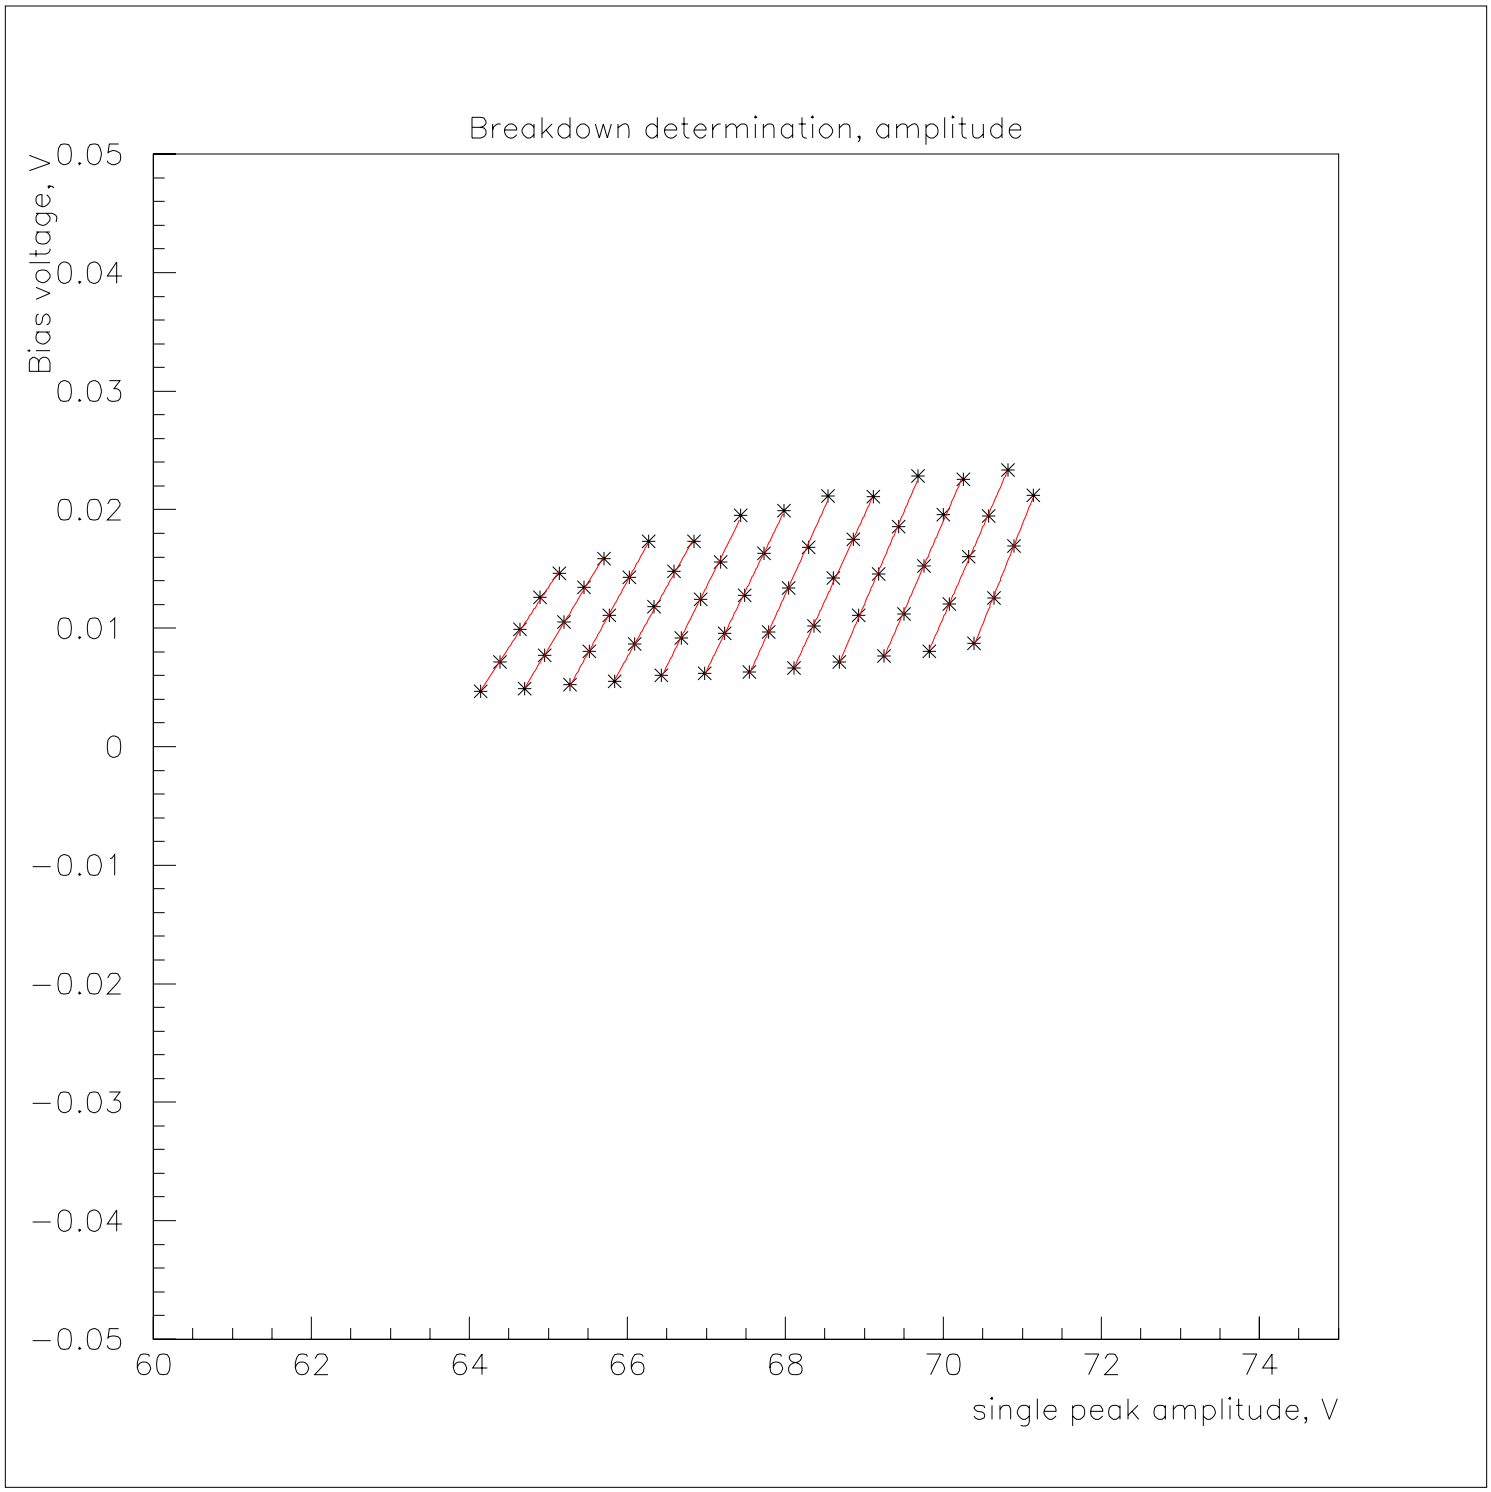
Breakdown determination, amplitude
Bias voltage, V
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
60
62
64
66
68
70
72
74
single peak amplitude, V

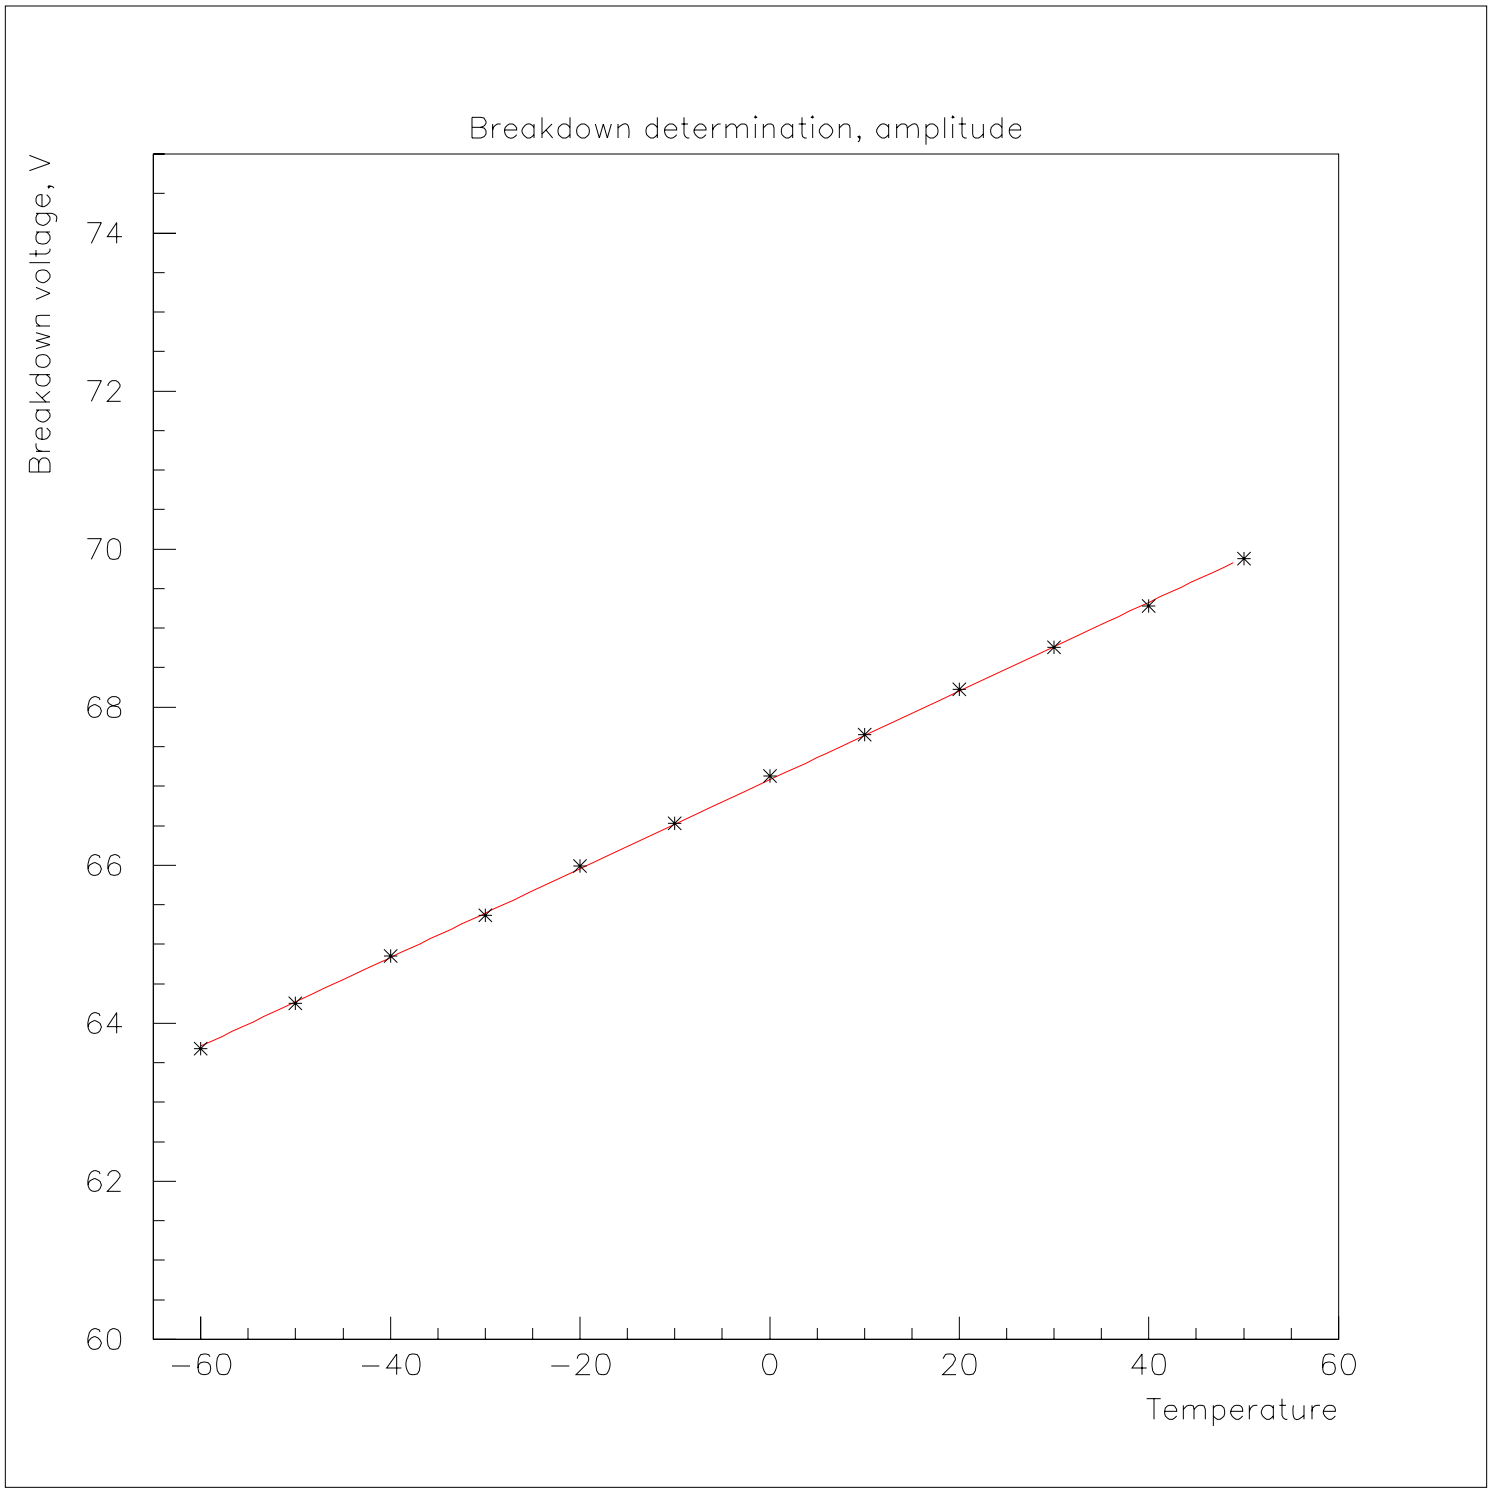
Breakdown determination, amplitude
Breakdown voltage, V
74
72
70
68
66
64
62
60
−60
−40
−20
0
20
40
60
Temperature

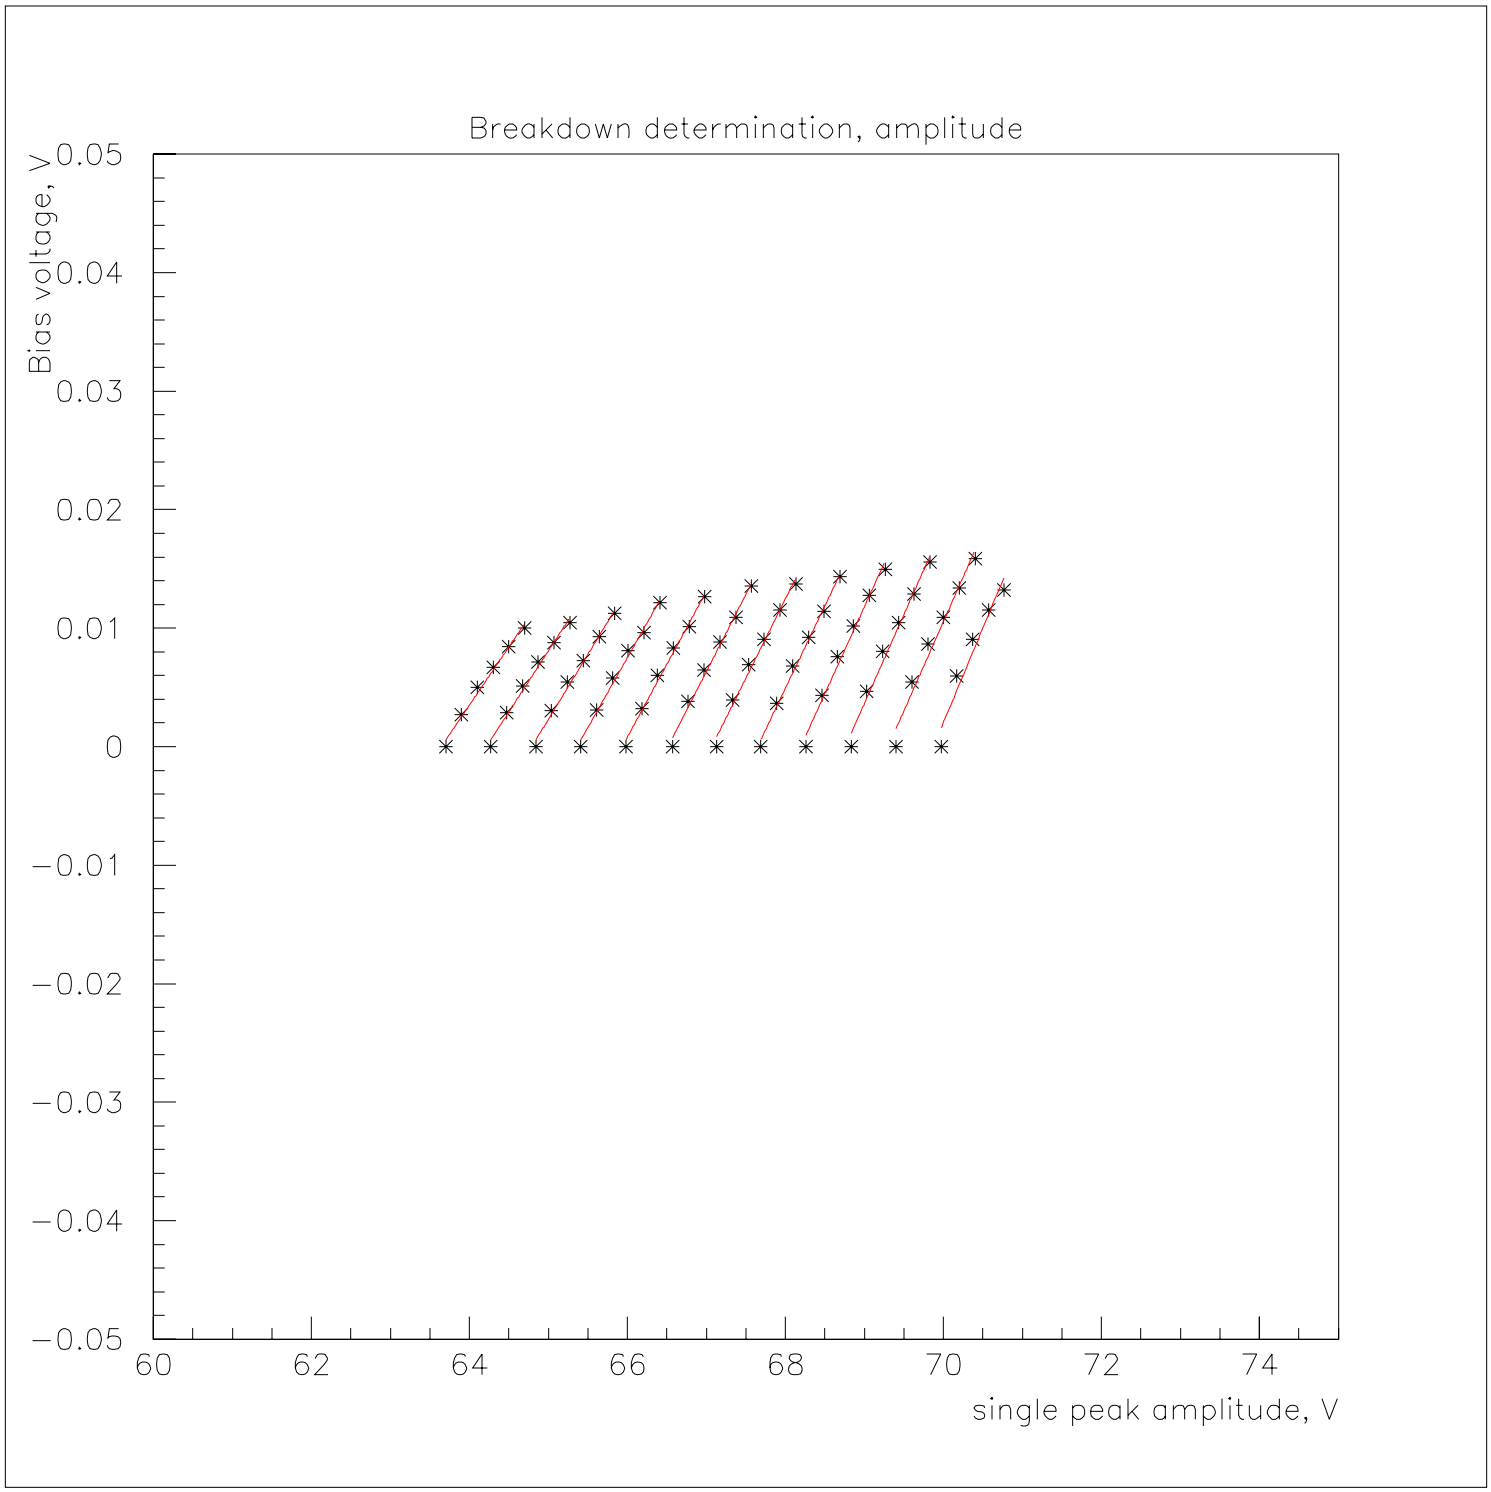
Breakdown determination, amplitude
Bias voltage, V
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
60
62
64
66
68
70
72
74
single peak amplitude, V

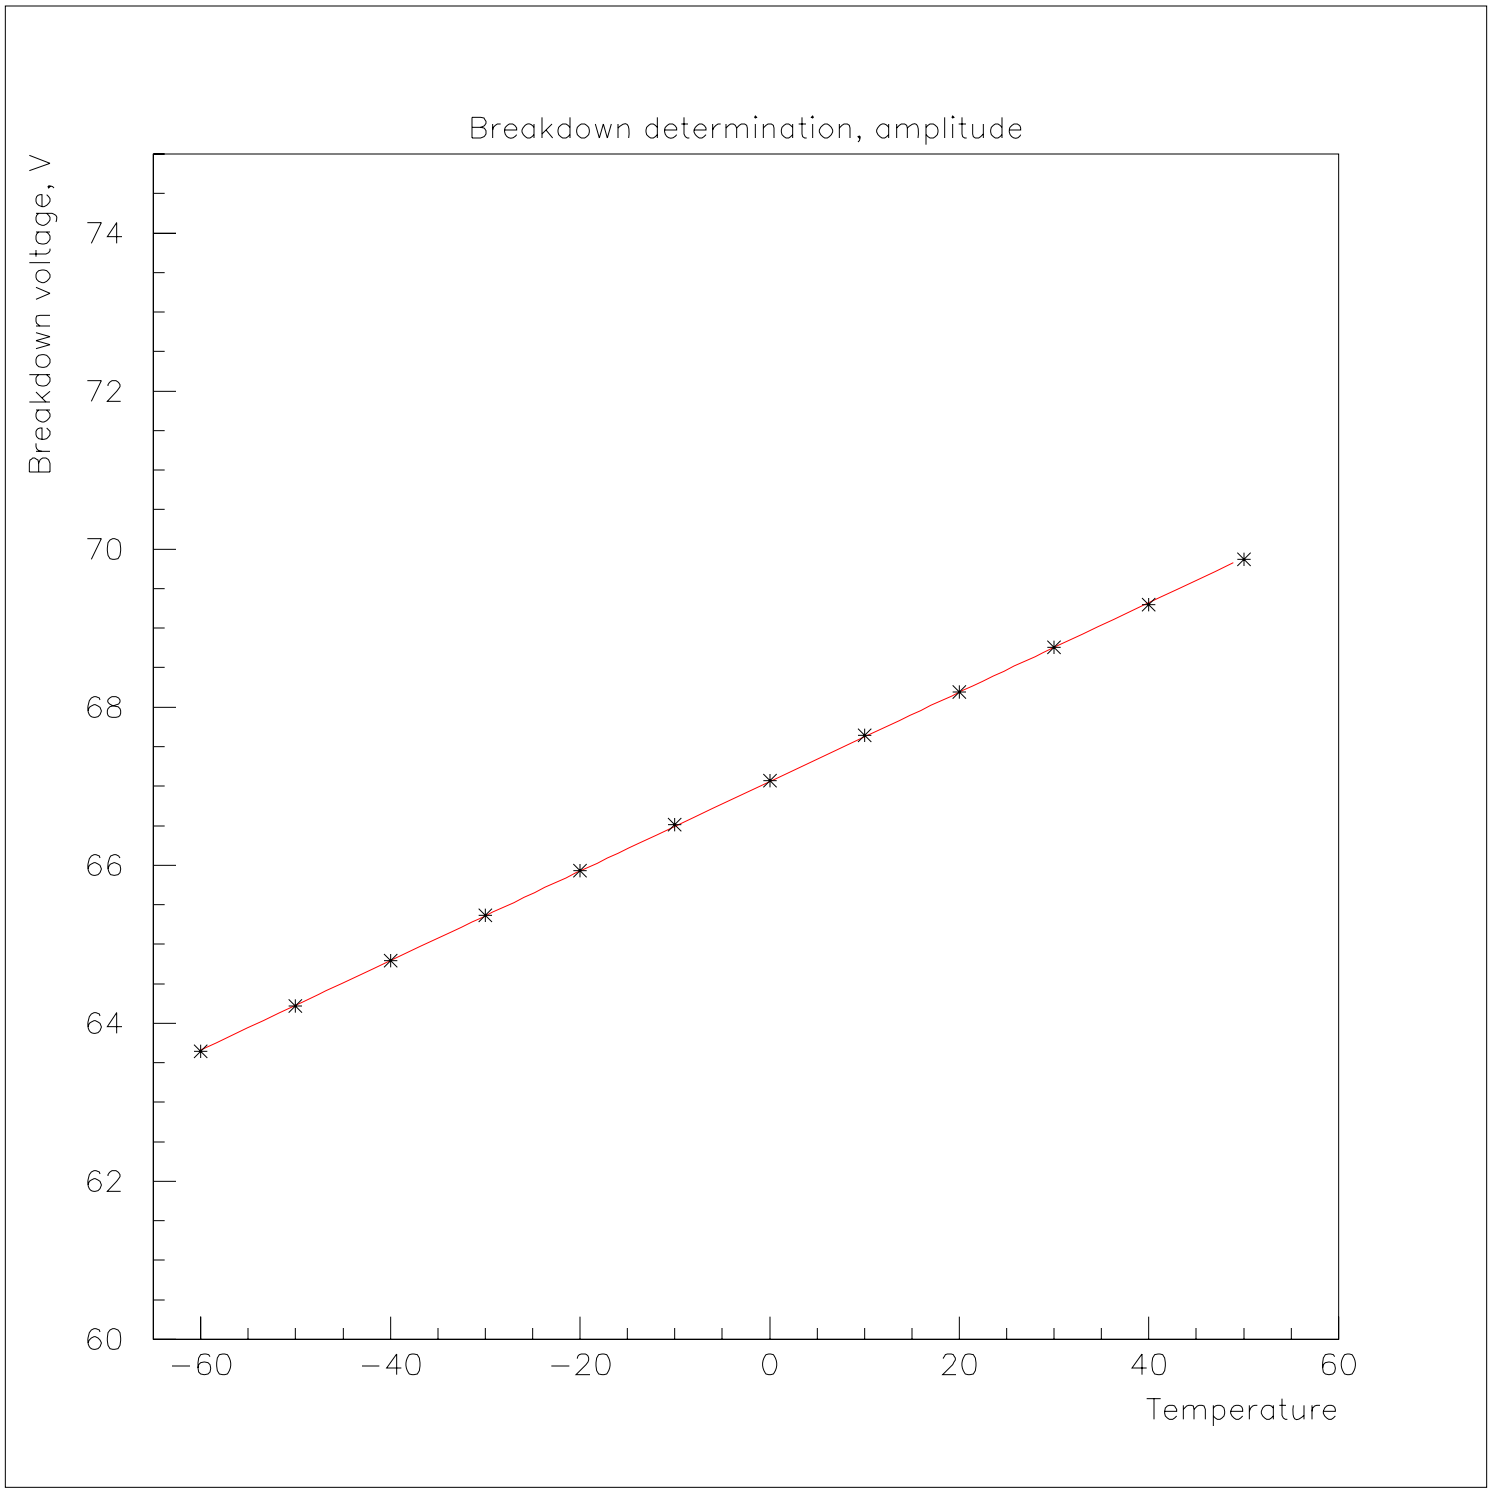
Breakdown determination, amplitude
Breakdown voltage, V
74
72
70
68
66
64
62
60
−60
−40
−20
0
20
40
60
Temperature