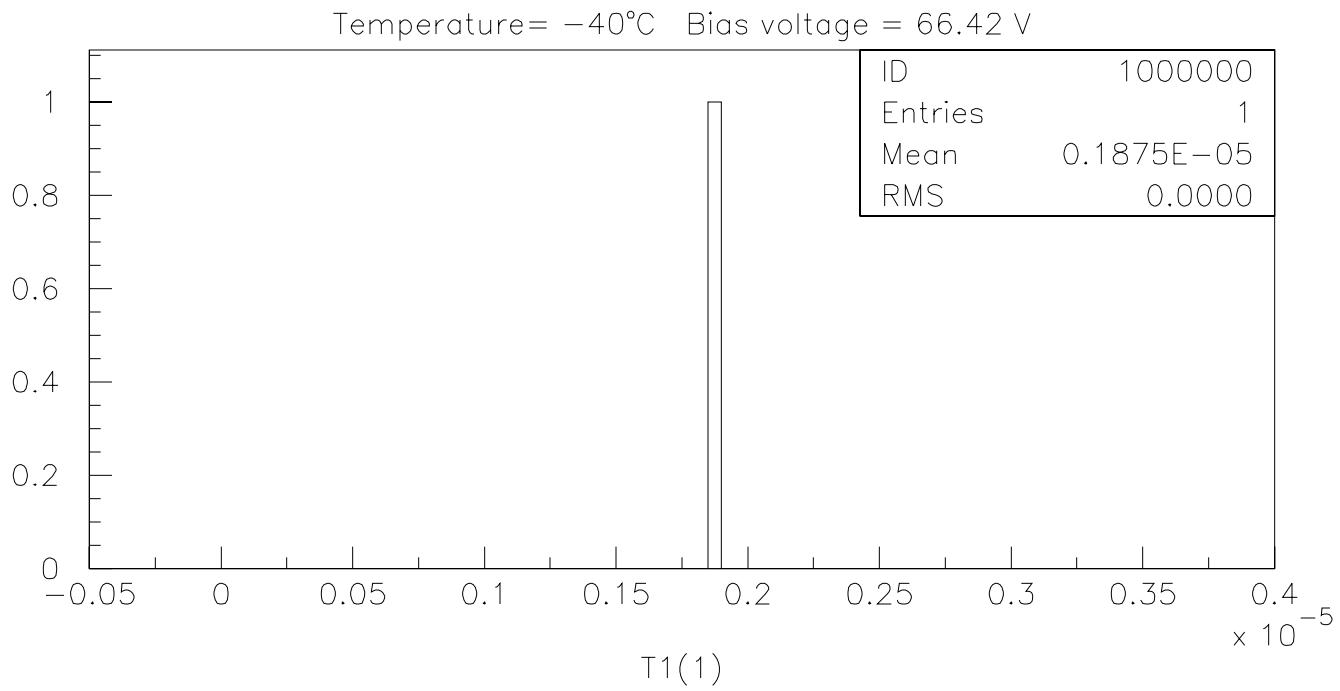
Temperature= −40°C Bias voltage = 66.42 V
ID 1000000
Entries 1
Mean 0.1875E−05
RMS 0.0000
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
x 10−5
T1(1)

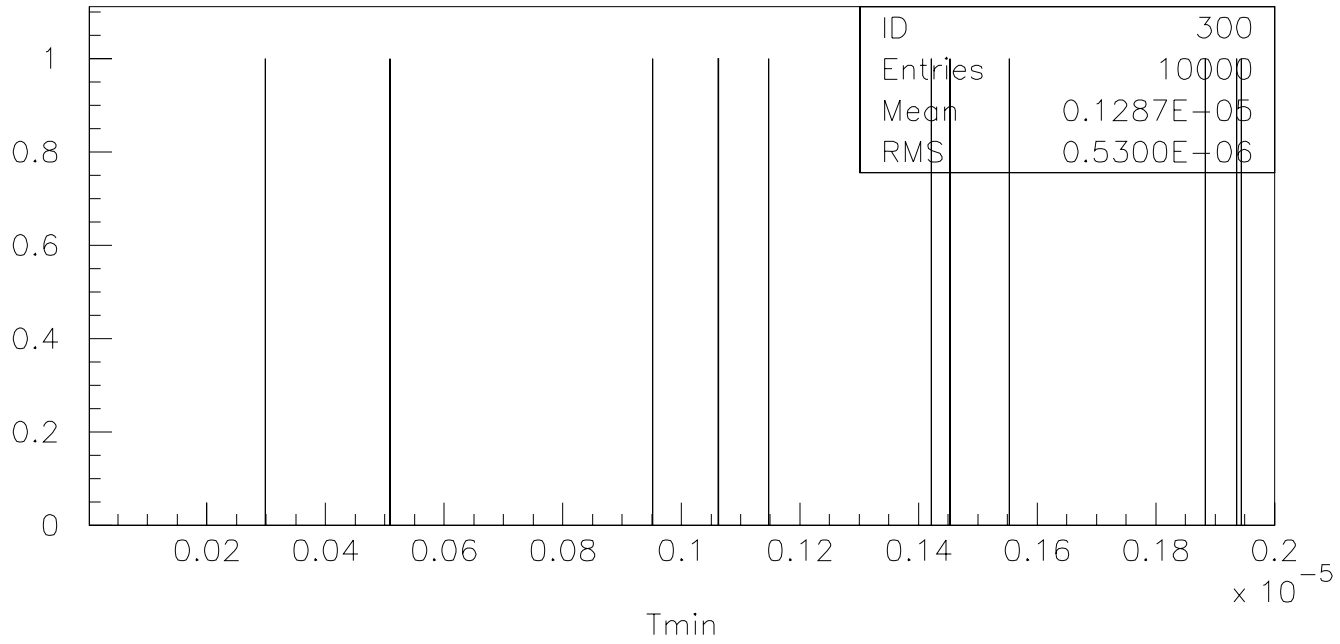
ID 300
Entries 10000
Mean 0.1287E−05
RMS 0.5300E−06
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
x 10−5
Tmin